

# ZY SMART

IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA EXTRASINUSALE  
BY LEADER MEDICA



# IMPIANTO

## ZY Smart

L'implantologia zigomatica extrasinusale, evoluzione delle prime tecniche intrasinusali che prevedono la perforazione del seno mascellare, consente oggi di semplificare la procedura chirurgica, riducendo i tempi ed i rischi intraoperatori, limitando inoltre le complicanze post operatorie per i pazienti.

**Leader Medica**, in collaborazione con il dr. Matteo Giorgi, ha sviluppato la sistemica **ZY Smart**, che comprende un impianto progettato per semplificare la chirurgia zigomatica ed un kit chirurgico semplice ed intuitivo. La fresa diamantata, e' disegnata per la corticotomia cilindrica ad appoggio mascellare, utile a semplificare la sequenza chirurgica di preparazione del sito.

**Leader Medica** mette a disposizione del medico un completo percorso formativo teorico e pratico su paziente, al fine di approcciare piu' facilmente questa pratica chirurgica, oggi sempre piu' proposta ai pazienti con severi riassorbimenti del mascellare.

([www.leadermedica/implantologia/corsi](http://www.leadermedica/implantologia/corsi))

**ZY Smart** è prodotto in Titanio grado 4 puro, "cold worked".



**A)** Zona per ancoraggio osso mascellare L=6mm. Superficie microfilettata con passo 0.4mm e anodizzazione mimetica gialla. Consente un miglior ancoraggio, la riduzione del riassorbimento crestale e dell'accumulo di placca. Unico diametro 4.2mm con connessione esagono interno Ø 3.75 compatibile.

**B)** Zona ad altezza variabile con superficie macchinata. Mini invasiva con le strutture extrasinusali.

**C)** Zona per ancoraggio zigomatico L=18mm. Superficie doppia acidatura, Aluminium Free, con spira a doppio passo a profilo automaschiante. Consente un facile inserimento nell'osso zigomatico.



CODICE	DESCRIZIONE
Z4235	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 35 MM
Z4237	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 37,5 MM
Z4240	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 40 MM
Z4242	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 42,5 MM
Z4245	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 45 MM
Z4247	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 47,5 MM
Z4250	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 50 MM
Z4252	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 52,5 MM
Z4255	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 55 MM
Z4260	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 60 MM



**TIS100222**

Moncone in titanio per M.F.A.



**MITO4560**

M.F.A. angolato 45°, H=6




**TIS90000 3**

Transfer per M.F.A.



**TIS900001**

Analogo per M.F.A.

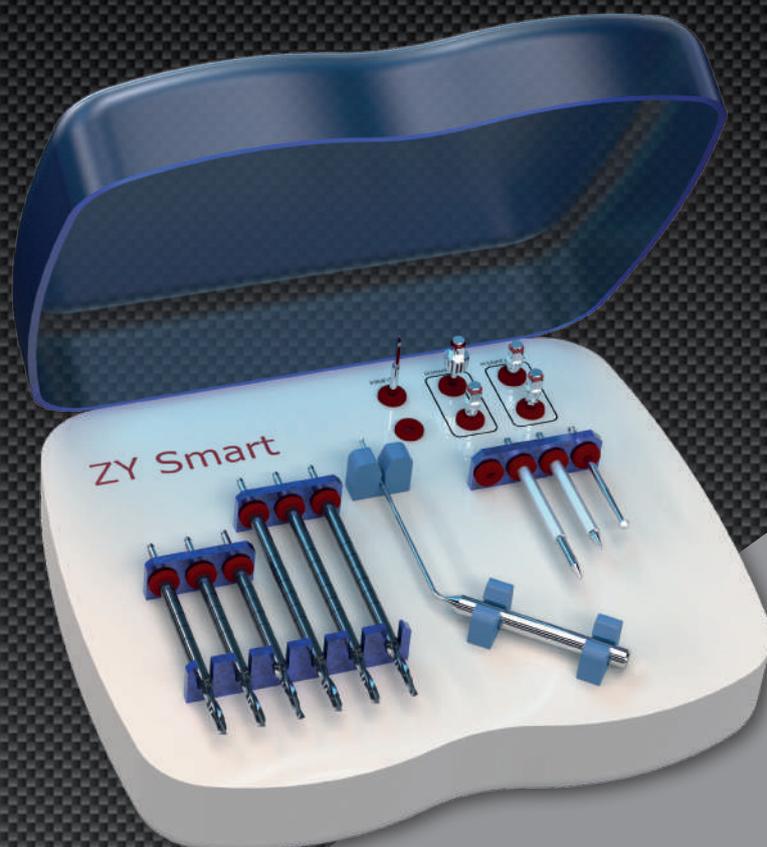

**LEADER MEDICA S.R.L.**

**Sede legale:** Via Longhin, 11  
35129 Padova - Italy

**Sede operativa:** Via Dell'industria, 13  
35030 Bastia di Rovolon (PD) - Italy

Tel. +39 049 9913364 - Fax +39 049 9910770 - e-mail: [info@leadermedica.com](mailto:info@leadermedica.com) - [www.leadermedica.com](http://www.leadermedica.com)

